KLESZCZE FEHLING TRADITION X

1) Części składowe / podstawa wyjaśnienia

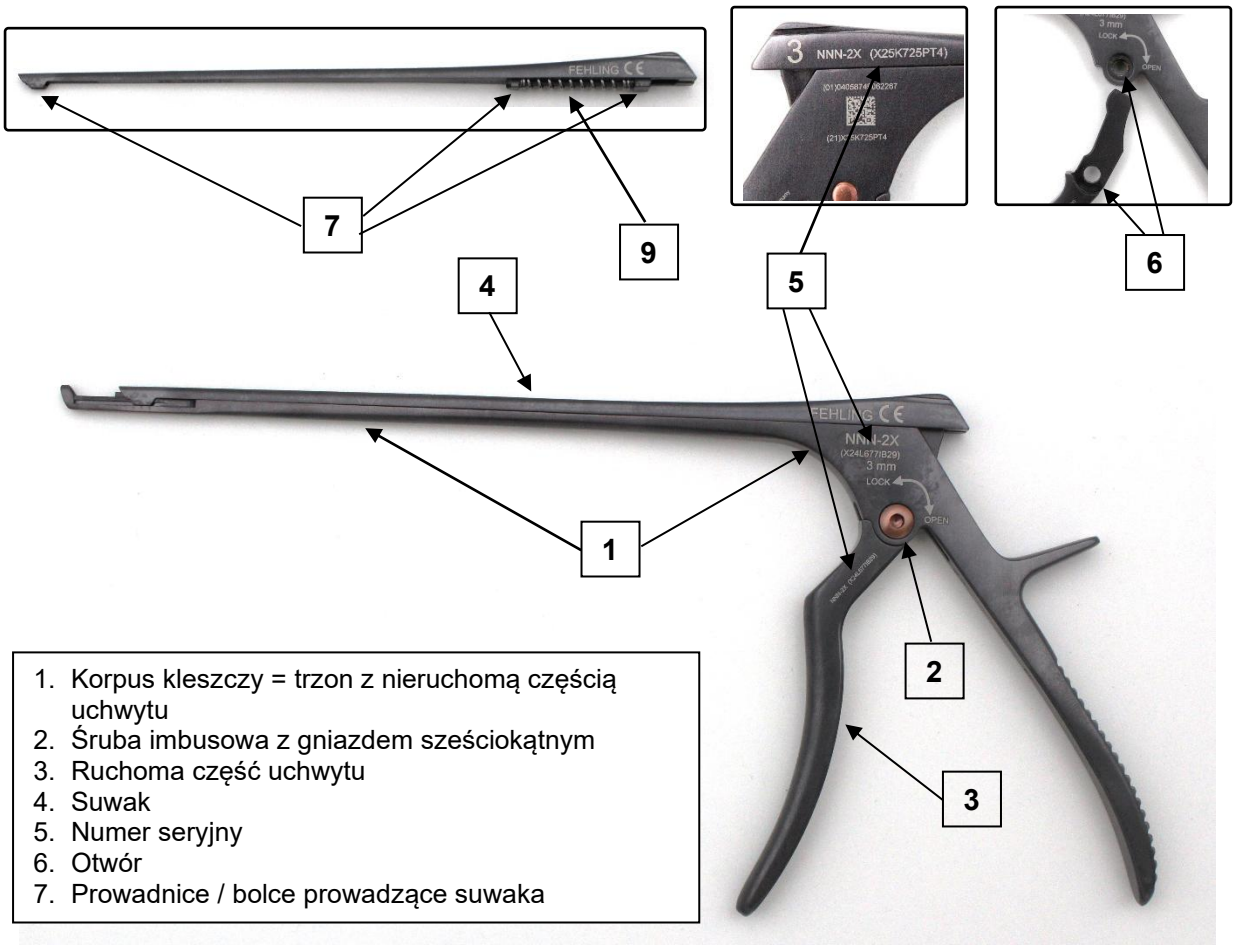

1. Korpus kleszczy = trzon z nieruchomą częścią uchwytu
2. Śruba imbusowa z gniazdem sześciokątnym
3. Ruchoma część uchwytu
4. Suwak
5. Numer seryjny
6. Otwór
7. Prowadnice / bolce prowadzące suwaka

2) Demontaż

1. W celu wykonania demontażu kleszcze położyć na stabilnej powierzchni roboczej. Odkręcić śrubę imbusową z gniazdem sześciokątnym (2) za pomocą wkrętaka TXX-0X (alternatywnie sterylizowalnego wkrętaka TXW-9X) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć ją z otworu gwintowanego.



2. Pociągnąć ruchomą część uchwytu (3) w dół i oddzielić ją od korpusu kleszczy (1). W celu ułatwienia odblokowania, suwak (4) należy równocześnie przesunąć w kierunku stopy kleszczy.



⚠ Po zdjęciu ruchomej części uchwytu (3) suwak (4) automatycznie rozłączy się.

3. Teraz w prosty sposób zdjąć można suwak (4) z korpusu kleszczy (1).



4. Cztery pojedyncze części zawsze poddawać regeneracji razem w tym samym pojemniku.



⚠ Korpus kleszczy (1), ruchoma część uchwytu (3) oraz suwak (4) są oznaczone identycznym numerem seryjnym do kontroli (5), przykładowo X25K725PT4. Składać można wyłącznie części instrumentu o tym samym numerze seryjnym (5).

3) Montaż

1. Założyć suwak (4) wraz ze sprężyną (8) na trzon (1). Przy czym prowadnice / bolce prowadzące (7) suwaka (4) należy wsunąć do odpowiednich gniazd w trzonie (1).







⚠ Prowadnice / bolce prowadzące (7) suwaka (4) muszą wsunąć się do odpowiednich gniazd w trzonie korpusu kleszczy (1).

2. Powoli wciskać suwak (4) w kierunku stopy kleszczy do momentu, aż koniec suwaka (4) będzie przesunięty o około 5 mm poza koniec trzonu w kierunku stopy kleszczy.



3. Nie zmieniając pozycji suwaka (4) i trzonu (1), wsunąć ruchomą część uchwytu (3) do korpusu kleszczy (1). Sprawdzić, czy otwory (6) ruchomej części uchwytu (3) i korpusu kleszczy (1) znajdują się precyzyjnie jeden nad drugim.



4. Wkręcić śrubę imbusową z gniazdem sześciokątnym (2) za pomocą wkrętaka TXX-0X (alternatywnie sterylizowalnego wkrętaka TXW-9X) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do przewidzianego otworu gwintowanego. Dokręcić śrubę do końca, ale bez użycia siły.



⚠ Nie przekręcać nadmiernie!

5. Po wykonaniu testu działania, można ponownie używać kleszcze.



⚠

- Ta śruba imbusowa z gniazdem sześciokątnym ma gwint lewy. Podczas odkręcania i wkręcania śrub imbusowych z gniazdem sześciokątnym koniecznie uwzględnić kierunek obrotu.
- Podczas odkręcania i wkręcania śruby imbusowej z gniazdem sześciokątnym nie używać siły, gdyż nie jest to konieczne. Wkręcanie śruby przy użyciu nadmiernej siły spowoduje uszkodzenie gniazda sześciokątnego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia gniazda sześciokątnego lub końcówki wkrętaka, należy wymienić bezzwłocznie śrubę imbusową z gniazdem sześciokątnym i wkrętak lub zlecić wymianę producentowi.
- Wkrętak TXX-0X myć można zimną wodą i delikatnym środkiem czyszczącym. Nie jest on przeznaczony do czyszczenia w gorącej wodzie i sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C.

Symbole		
O ile symbole takie znajdują się na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub w instrukcji używania, to mają one następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznać się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	

Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	