FEHLING CHORDAE-MÄTINSTRUMENT OCH KNUTASSISTENT

MNV-4, MNV-7, MNV-9

1) Komponenter / grund för deklaration

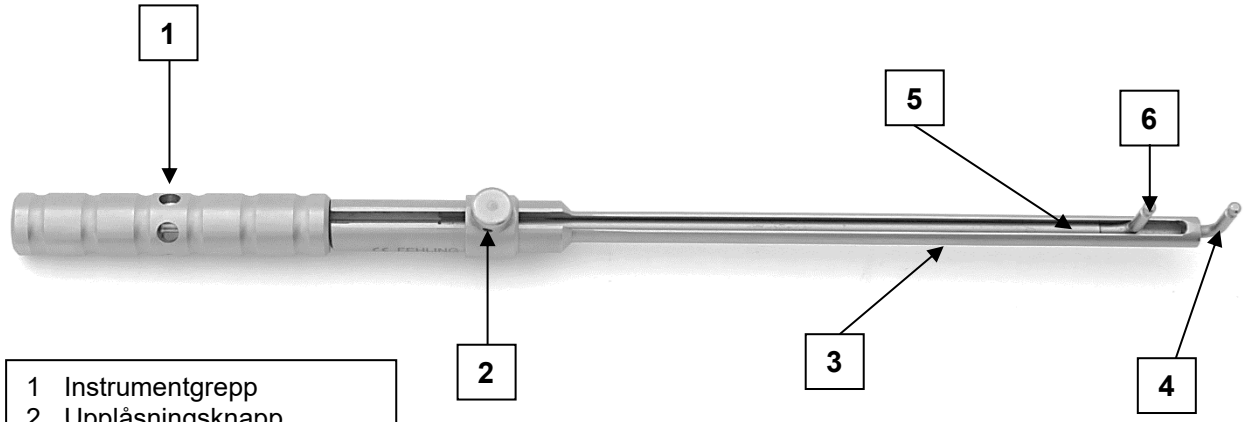

1 Instrumentgrepp
2 Upplåsningsknapp
3 Instrumentskaft
4 Skaftets arbetsände
5 Instrumentreglage
6 Skjutreglagets arbetsände

2) Demontering

1. Vrid instrumentgreppet (1) moturs tills instrumentgreppet (1) är helt upplåst.

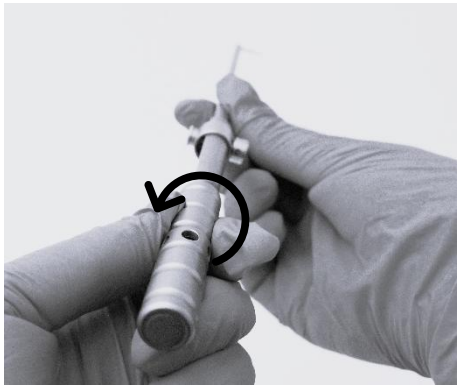

2. I nästa steg tar du bort instrumentreglaget (5). För att göra detta trycker du in upplåsningsknappen (2) mot skaftet och drar samtidigt ut instrumentreglaget (5) helt mot skaftänden.

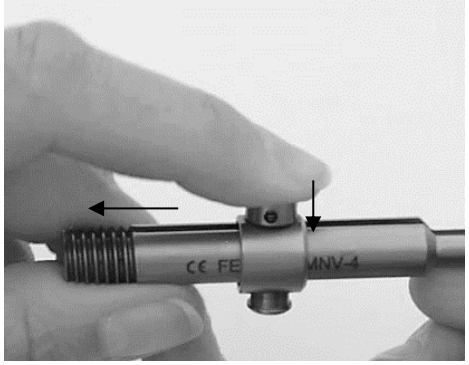

3. Instrumentet, som demonterats i sina tre enskilda delar, kan nu reprocessas.

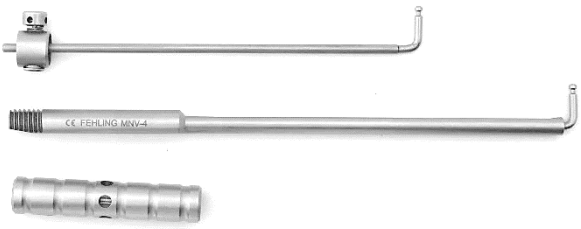

3) Montering

1. För in instrumentreglaget (5) i skaftänden och skjut det förbi gängan i riktning mot arbetsänden (4). Under tiden trycker du upplåsningsknappen (2) mot skaftet.

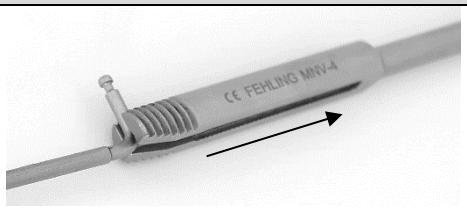

⚠ Se till att arbetsändarna på instrumentreglaget (5) och instrumentskaftet (3) pekar åt samma håll.

2. Vrid slutligen instrumentgreppet (1) medurs på axelgängan (3).

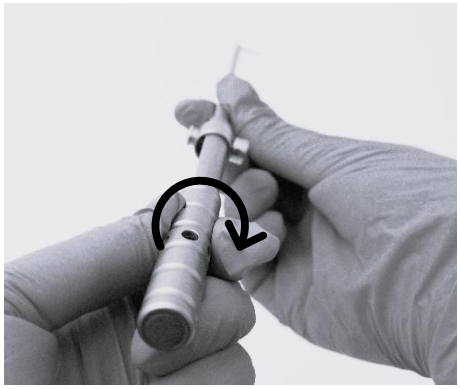

3. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.



Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
Tillverkare	Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	Viktigt
REF Katalognummer	LOT Batchkod	SN Serienummer
MD Medicinteknisk produkt	UDI Unik enhetsidentifierare	CE 0297 CE-märkning
Oljekanna för smörjställen	CE CE-märkning	

Tillverkarens kontaktuppgifter		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	CE